取扱説明書

電動昇降式
ＡＤＬ洗面化粧台
ＳＡＤ－２１０

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
  正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- 「取扱説明書」は
  ・1 部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
  ・1 部を保存用として、大切に保管してください。

SAKAImed

06-025⑤JY

もくじ

安全上のご注意 …… 3

各部の名称 …… 5

ご使用になる前に …… 6
- 電源 …… 6
- 周囲の点検 …… 6

操作方法 …… 7
- 洗面台の昇降 …… 7
- シングルレバー混合水栓 …… 7
- 鏡角度調節 …… 8
- 蛍光灯 …… 8
- コンセント …… 9
- 測定用スケール …… 9

お手入れの仕方 …… 10

このようなときには …… 10

機器の保守・点検について …… 11

保証とアフターサービス …… 12

仕 様 …… 13

用途

本装置は、ADL トレーニングにおける洗面動作トレーニングのためのもので、種々の条件を再現するために、洗面台高さと鏡の角度を調節できるようにした上下調節式洗面ユニットです。

特長

● 省スペースのコンパクトタイプＡＤＬ洗面化粧台。

立位でも車椅子でも十分写る角度調節式の大きな鏡と左右の化粧棚を標準装備していますので様々なトレーニングが行えます。

● 操作性の向上を図りました。

昇降スイッチは使用者から届き易く、洗面時に邪魔にならないように、くびれた化粧棚の中心にレイアウトして使い易さを追求しました。

高さ調節機構は電動式のためスムーズな昇降、停止が可能です。

トレーニングの目安として利用できるよう、洗面台上面高さのスケールを設けました。

● 衛生度の向上を図りました。

スイッチ部には抗菌シートを採用。

安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、
各注意事項をよくお読みのうえ、
必ずお守りください。

注意事項を次のように区分しています。

⚠危険 ・・・ 取り扱いを誤ると、
死亡または重傷を負うことに至るもの

⚠警告 ・・・ 取り扱いを誤ると、
死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの

⚠注意 ・・・ 取り扱いを誤ると、
傷害または物的損害の発生が想定されるもの

絵表示の意味

禁　止：してはいけない「禁止」内容のものです。

強　制：必ず実行していただく「指示」内容のものです。

電源・その他

⚠警告

サービスマン以外は、電源の接続を行わない
正しく接続しないと故障や事故の原因になります。

コンセントは 1500W以上の器具を使用しない
器具の故障及び感電の恐れがあります。

⚠注意

コンセント電圧は AC100V±5%の範囲内で使用する
範囲外の場合には機器の故障及び誤動作の原因になります。

サービスマン以外は、給湯水の接続を行わない
正しく接続しないと水もれ等の故障や事故の原因になります。

給湯水栓

⚠注意

湯温に注意
止水後、再び吐水するときは、若干温度が変化することがありますのでしばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。

レバーハンドルはゆっくり動かす
急に操作すると音が出たり、吐出温度が急に変わります。

付属の洗面器用シングルレバー混合水栓の「ご愛用のしおり」をよく読む
各注意事項をお守りください。

熱湯を吐出させたときの給湯部に注意
高温になっていますので、やけどに十分注意してください。熱湯の吐出後は、安全のためしばらく水を流して冷やしてください。

洗面台の昇降

⚠ 注意

使用者が洗面台を使用中には、絶対に操作しない
思わぬ事故につながります。

洗面器には、50kg 以上の力を掛けない
故障の原因や事故につながる恐れがあります。

昇降の切り換えは、必ず動作の停止を確認してから行う
動作中に行うと機械の故障及び誤作動の原因となります。

下降させるときは、昇降枠及び洗面器の下側に注意
足等が挟み込まれる恐れがあります。

洗面台を昇降させるときには、いつでも停止できるようにする
挟み込み等がないように注意してください。

使用上の注意

⚠ 注意

手すりには 50 kg以上の力を掛けない
破損する恐れがあります。

化粧台には 5 kg以上の物を置かない
破損する場合があります。

清掃時にシンナー，ベンジンなどで拭かない
塗装及び製品表面を侵す恐れがあるので使用しないでください。

機器の改造はしない
故障の原因や事故につながる恐れがあります。

クレンザー等の研磨剤や酸性洗剤などは使用しない
みがき粉等の粒子を含んだ洗剤やナイロンタワシ，ブラシ等は塗装等の表面を傷つけます。

蛍光灯の取り扱い注意
濡れた手やスイッチを入れたままで交換しないでください。感電の恐れがあります。

医師や指導者の指示に従ってトレーニングを行う
指示以外のトレーニングはけがや事故の恐れがあります。

使用後は、必ず本体の電源を切る
電化製品は、必ず電源プラグを抜いてください。事故を防止します。

各部の名称

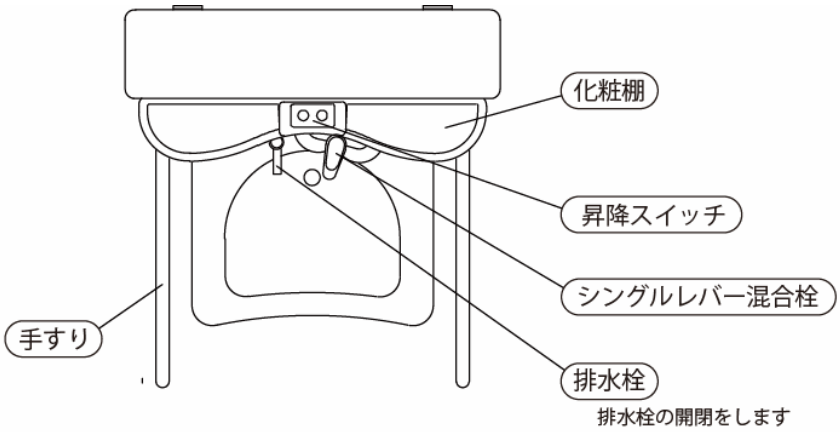

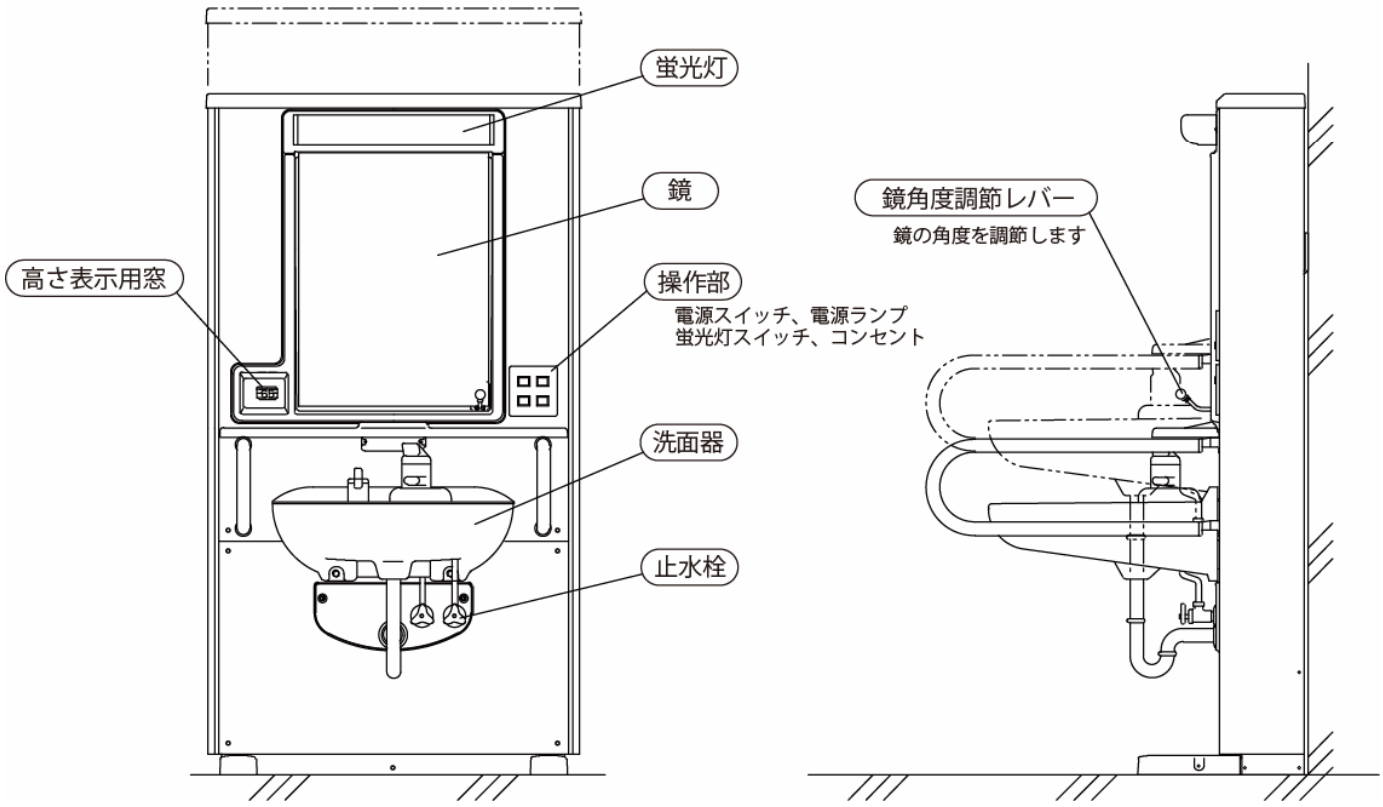

✹ 構成

- ＡＤＬ洗面化粧台　・・・SAD-210
  本体　・・・1台

ご使用になる前に

ご使用前に本製品について P.11 の**始業点検項目**にもとづき、始業点検を実施してください。またこれ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになられていたときとは違う異常を感じましたら、本製品を使用せずに、電源を切って最寄りの営業所にご連絡ください。

破損、異常を感じたままのご使用は、危険ですから絶対におやめください。

電源

本製品は、設置時に電源は接続されています。使用前に必ず電源のヒューズやブレーカーが切れていないか点検してください。

電源には、必ず漏電遮断器を接続してください。

鏡右側にある電源スイッチを入れると、操作部の電源ランプ(緑)が点灯します。

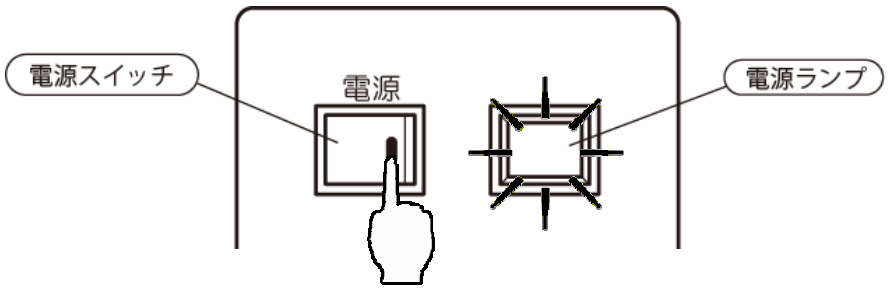

周囲の点検

本体昇降部の周囲に障害物がないことを確認してください。

操作方法

洗面台の昇降

洗面台の昇降は、化粧棚中心の昇降スイッチで操作します。

上昇…右側の上昇スイッチ⇧を押します。
上限（床面より洗面器上面まで 85 ㎝）で自動的に停止します。

下降…左側の下降スイッチ⇩を押します。
下限(同 65 ㎝)で自動的に停止します。

停止…昇降中にスイッチから手を離すと中間で停止します。

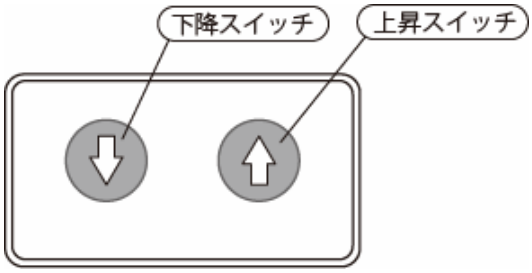

注意
- **使用者が洗面台を使用中には、絶対に昇降を操作しない**
  思わぬ事故につながります。
- **下降させるときは、昇降枠及び洗面器の下側に注意**
  足等が挟み込まれる恐れがあります。
- **昇降の切り換えは、必ず動作の停止を確認してから行う**
- **洗面器には、50kg 以上の力を掛けない**
- **洗面台を昇降させるときには、いつでも停止できるようにする**
  挟み込み等がないように注意してください。

シングルレバー混合水栓

レバーハンドルのワンタッチ操作で吐水、止水ができ、温度や吐水量も簡単に調節できます。

注意
- **レバーハンドルはゆっくり動かす**
- **熱湯を吐出させたときの給湯部に注意**
  高温になっていますので、やけどに十分注意してください。
- **湯温に注意**
  止水後、再び吐水する時は、若干温度が変化することがありますのでしばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。
- **付属の洗面器用シングルレバー混合水栓の「ご愛用のしおり」をよく読む**

鏡角度調節

鏡の角度は、車椅子でのアプローチ時に、下向きにして下半身が写せるように5°の範囲で5段階に調節できます。

角度調節は、①鏡角度調節レバーを下側に押し下げる、②前後にスライドさせる、③手をはなす の手順で行います。

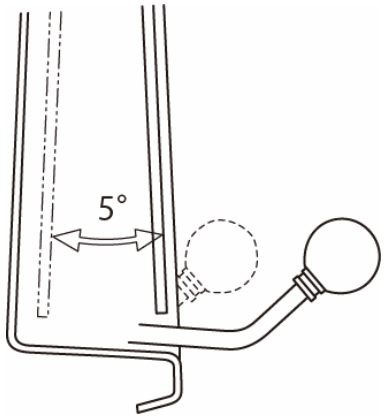

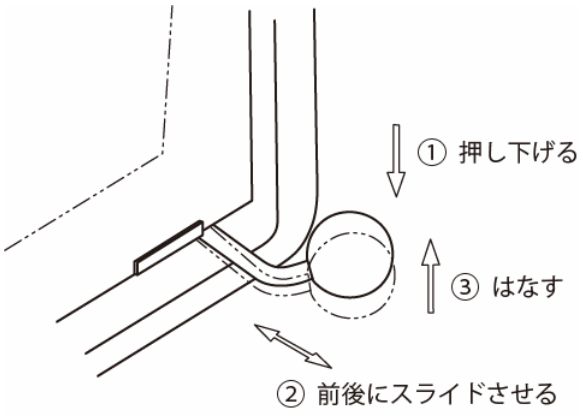

蛍光灯

上部蛍光灯は、操作部の蛍光灯スイッチで操作します。

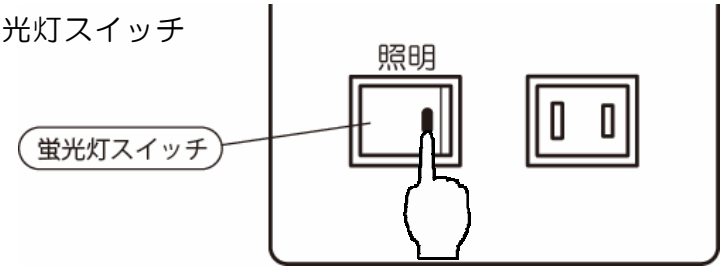

ご注意 蛍光燈の電源は、本体の電源スイッチと連動していますので、使用時は電源スイッチを入れてください。

蛍光灯の交換は蛍光灯スイッチを切ってから、蛍光灯カバーのネジを外して行います。蛍光灯のサイズをお確かめの上交換してください。

⚠注意　取り扱い注意

濡れた手やスイッチを入れたままで交換しないでください。感電の恐れがあります。

コンセント

操作部内のコンセントについては 1500Wまでの器具が接続できます。

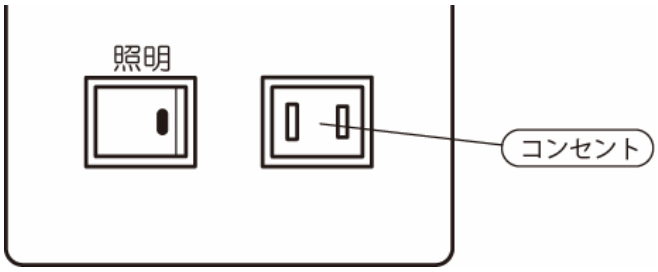

⚠ 警告　1500W以上の器具は使用しない

器具の故障及び感電の恐れがあります。

ご注意　コンセントの電源は、本体の電源スイッチと連動していますので、使用時は、電源スイッチを入れてください。

測定用スケール

評価測定の為の洗面器上面寸法を一目で測定できるようになっています。
高さ表示窓の ▶ ◀ の数字が洗面器上面の高さ（床から）を示しています。
目盛りは 1cm 単位で数字は 2cm ごとに表示します。

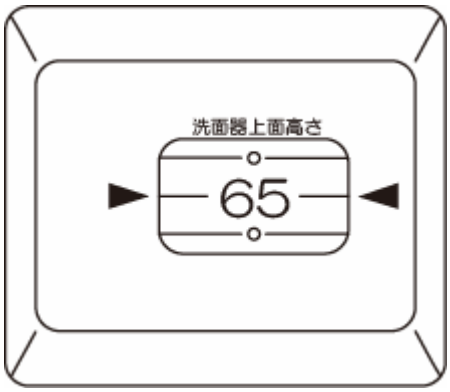

※ 図は洗面器上面高さが床面より 65cm を表示したときのものです。

お手入れの仕方

- 普段のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取り、その後水拭きして、柔らかい布で乾拭きしてください。

⚠ 注意　・クレンザー等の磨き粉を含んだ洗剤やナイロンタワシ等は使用しない
・シンナー，ベンジンなどで拭かない

このようなときには

症　状	原　因	対　策
電源が入らない。	電源が入っていない。	電源を入れてください。
	電気回路のトラブル。	最寄りの営業所にご連絡ください。
昇降しない。	スイッチが OFF になっている。	スイッチを ON にしてください。
	本体の故障。	最寄りの営業所にご連絡ください。
昇降中に変な音がする。	駆動装置のトラブル。	最寄りの営業所にご連絡ください。

- その他、ご不明な点につきましては最寄りの営業所にご相談ください。
- ご使用中、万一故障が発生したらただちに使用を中止し、電源を切ってください。

機器の保守・点検について

- 本製品については、機器の管理者の方が以下の点検項目にもとづき、必ず始業点検（日常の製品使用前）を実施してください。
- 長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、機器が正常に動作するか十分な点検を行ってください。
- **点検時に異常が発見された場合**は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
- 清掃等の簡単な保守は機器の管理者等によって実施するようお願いいたします。

始業点検項目

区分	点検内容	点検方法
外観	本体の周囲の障害物の有無	目視
	カバーのガタつき、取付ネジの緩み、脱落	目視 及び、触って確認
	給湯水栓からの水(湯)の漏れ	目視
機能	電源ランプの点灯	目視
	洗面台の昇降	スムーズに昇降するか、異音がないか確認

保証とアフターサービス

✹ 保証書と保証期間

- 保証書(別添)はよく読んで大切に保管してください。保証書がありませんと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- 保証期間は、正常な使用状態で故障した場合、本体フレームは 5 年間、それ以外は１年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

✹ 修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

  機種名　：　*SAD-210*
  お買い上げ年月：　　年　　月
  故障状況(できるだけ詳細に)
  住所，氏名，電話番号

- メーカーより指示のあるとき以外は、決してあけたり分解したりしないでください。

✹ 定期保守点検契約のお勧め

製品を長期間正常な状態で安全に使用できるように保証期間後の「保守点検契約」の締結をお勧めします。詳しくは「保守点検契約のお勧め」をご覧になるか、弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。

✹ 耐用期間

10 年：保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

✹ 消耗品（使用により、量などが減少していくもの）

蛍光灯

交換は、お客様により実施願います。

✹ 損耗品（使用により、磨耗･劣化･変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

- 正常な使用において、交換の目安が**約３年**のもの。

  排水ホース / 給湯・給水ホース / 止水栓パッキン

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

✹ 保守部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

仕 様

外形寸法		900(W)×915(D)×1640～1840(H)㎜
質　量		約 140 kg
電　源		単相 100V　50/60 Hz　15Ａ
電　力		120/130W
駆動方式		電動・チェーン方式
材質	本体フレーム	スチール製
	側面カバー	アクリル変性高衝撃塩ビ板
	正面カバー	特殊アクリル変性化粧合板
洗面器		ＴＯＴＯ製
給湯水		各１５Ａ
排水		４０Ａ
付帯機器		蛍光灯・コンセント

注）都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。